ООО "Научно Производственное Предприятие Аналитические Системы"
Россия, 117420, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2 стр. 19, этаж 1, помещение 05
ИНН 7728387282 КПП 772301001 ОГРН 5177746232648
Р/с 40702810087060000585 в Московском Филиале ПАО РОСБАНК
К/с 30101810000000000256 БИК 044525256
Тел.: +7 (495) 167 66 67 wwww.asys-npp.ru E-mail: info@asys-npp.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА ВЫБРОСОВ

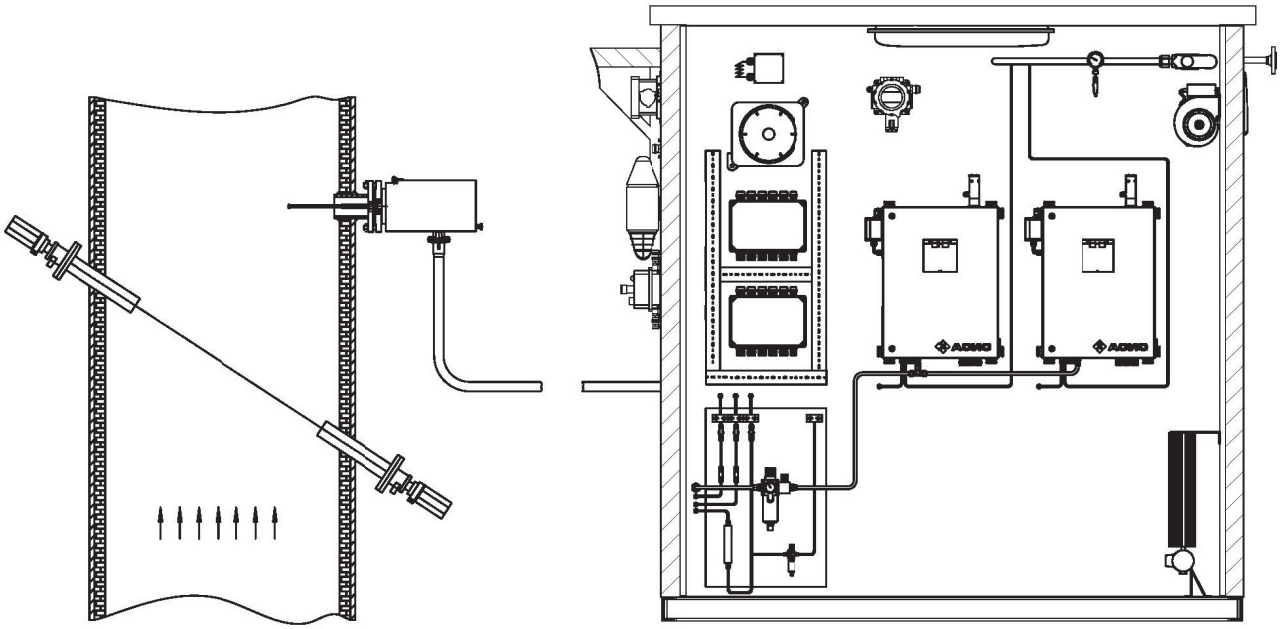

1. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

ФИО: _____

Должность: _____

Телефон: _____ E-mail: _____

Организация: _____

Адрес: _____

2. ДАННЫЕ О ПРОЕКТЕ

Технологическая установка: _____

Технологическая позиция (TAG №): _____

ВИД ТОПЛИВА: основное _____ резервное _____

Примечания:

3. СОСТАВ ПРОБЫ / ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ

ВЕЩЕСТВО	ЕД. ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЯ			ПДВ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ
		МИН.	НОРМА	МАКС.		
O_2	% об.					
H_2O	% об.					
NO	мг/м^3					
NO_2	мг/м^3					
CO	мг/м^3					
SO_2	мг/м^3					
HF	мг/м^3					
HCl	мг/м^3					
H_2S	мг/м^3					
NH_3	мг/м^3					
CO_2	% об.					
CH_4	мг/м^3					
Пыль / мех. частицы	мг/м^3					

Примечание: Сумма объемных (массовых) долей пробы должна составлять 100%!

4. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОБЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЯ		
		МИН.	НОРМА	МАКС.
Давление (изб./абс.)				
Температура	°C			
Скорость потока	м/с			
Объемный расход	м^3/ч			
Массовый расход	кг/ч			
Плотность среды	кг/м^3			
Размер частиц	мкм			
Точка росы	°C			

5. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ В ТОЧКЕ ВРЕЗКИ

Диаметр трубопровода / сечение газохода:
Толщина стенки (без изоляции) / материал:
Толщина изоляции / материал:
Тип присоединения:
Расстояние от врезки до анализатора (длина импульсной линии):

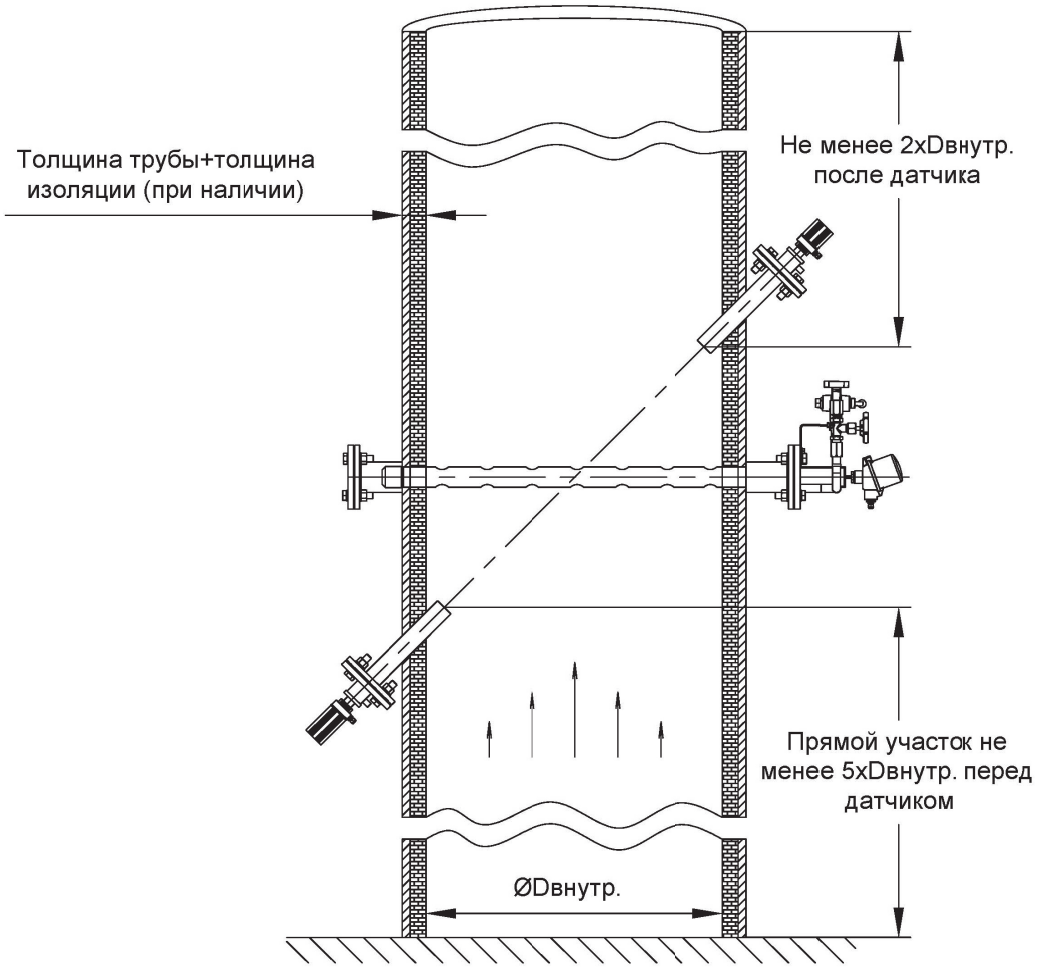

По возможности предоставить паспорт трубы и чертеж общего вида трубы!

6. ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Классификация взрывоопасной зоны	Невзрывоопасная	Взрывоопасная (классиф-я по ПУЭ, ГОСТ)
В точке врезки		
В месте установки анализатора		

Температура окружающей среды	В точке врезки	В месте установки анализатора

7. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Воздух (указать давление):
Азот (указать давление):
Пар (указать давление и температуру):
Электропитание (указать напряжение и частоту):

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПТК СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

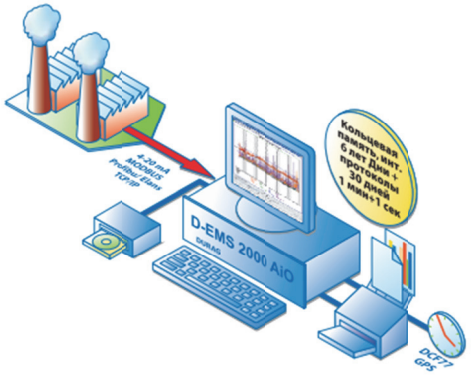

	ТРЕБОВАНИЯ
Сервер БД	
Интеграция в АСУ предприятия (выходные сигналы)	
Линейные ПК пользователей (АРМ оператора, эколога)	
Дополнительные требования	

9. ПРИМЕЧАНИЯ